

TESTA med[®]
DIAGNOSTICS

Der Zyklus beginnt mit dem 1. Tag der Menstruation. Der Zyklusverlauf lässt sich in 3 Phasen einteilen:

Follikelphase:


Eine Eizelle reift heran.

Eisprungphase:

Die Eizelle verlässt den Eierstock. Das ist der Zeitpunkt einer möglichen Befruchtung.

Gelbkörperphase:

Wurde die Eizelle befruchtet, bildet sich das Schwangerschaftshormon hCG und steigt messbar an.

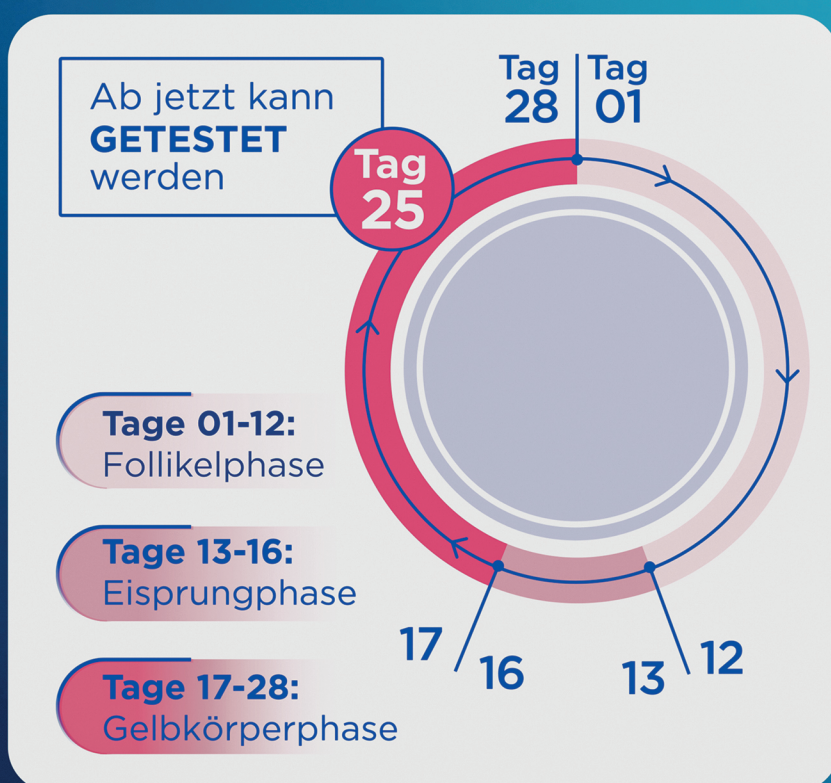

Der TESTAmed DIAGNOSTICS Schwangerschaftsfrühtest misst

- zu 99 % zuverlässig¹
- schon 5 Tage früher²
- mit einer Sensitivität von 20 mIU/ml

Bei Raumtemperatur lagern: 2-30°C.
Zur Eigenanwendung, Mittelstrahltest. Nicht zur Empfängnisverhütung bestimmt. Nur für in-vitro-Diagnostik (nicht zum Einnehmen). In-Vitro Diagnosticum

Beratungsservice
Tel. 06742/900 291 www.testamed.de